

心肺复苏量化培训报告

评估时间: 2018年7月27日 18:45:00

评估导师: 导师1

轮数: 第1轮

学员信息

姓名: 18

性别:


编号: 18

单位:

科室:

职务:

波形图

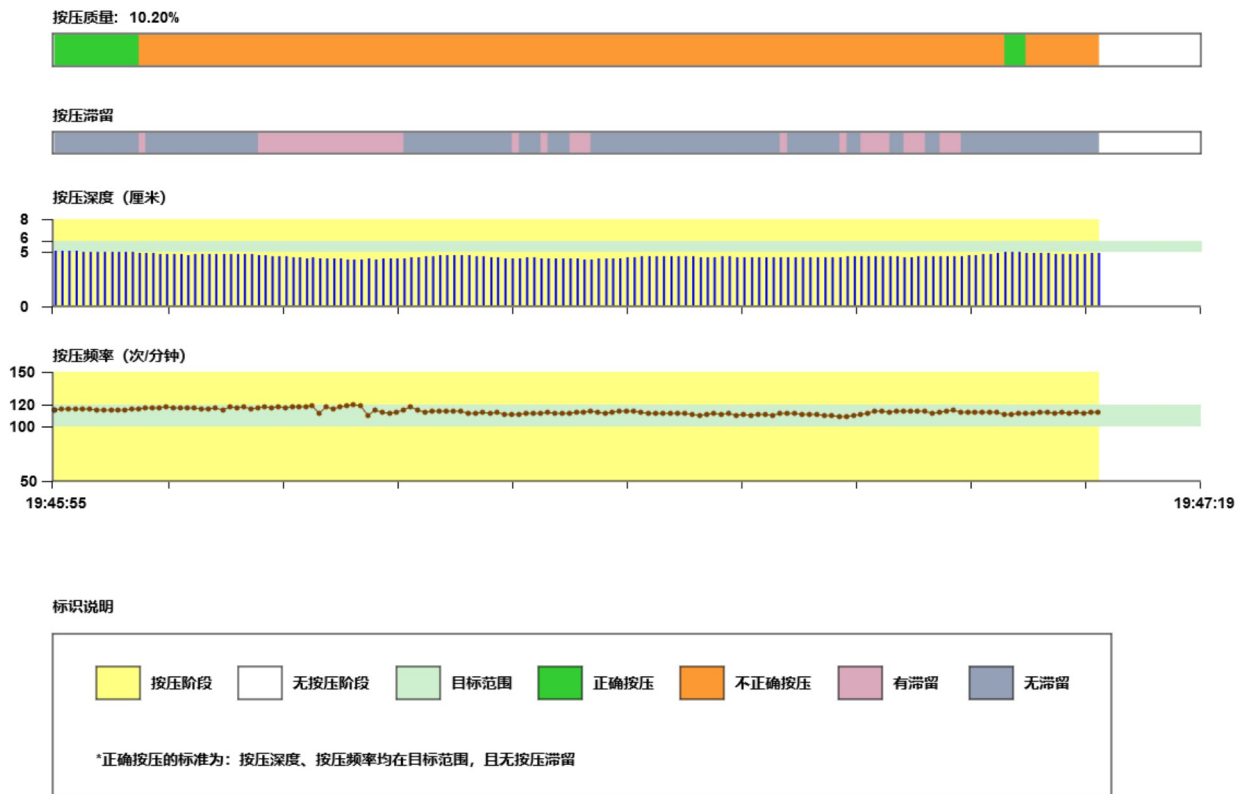

按压数据统计

按压质量	数据统计
总时间: 00:01:24	按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]
CCF: 91%	按压深度达标(5-6厘米): 15次 [10.20%]
平均深度: 4.6厘米	按压太浅(小于5厘米): 132次 [89.80%]
平均频率: 113次/分钟	按压太快(超过120次/分钟): 0次 [0.00%]
总次数: 147次	按压频率达标(100-120次/分钟): 147次 [100.00%]
正确次数: 15次	按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]
正确率: 10.20%	按压时间: 00:01:16
按压滞留: 39次 [26.53%]	按压中断时间: 00:00:08

导师签名: