

## 心肺复苏量化培训报告

评估时间: 2018年7月27日 18:45:00

评估导师: 导师1

轮数: 第1轮

## 学员信息

姓名: 20

性别:


编号: 20

单位:

科室:

职务:

## 波形图

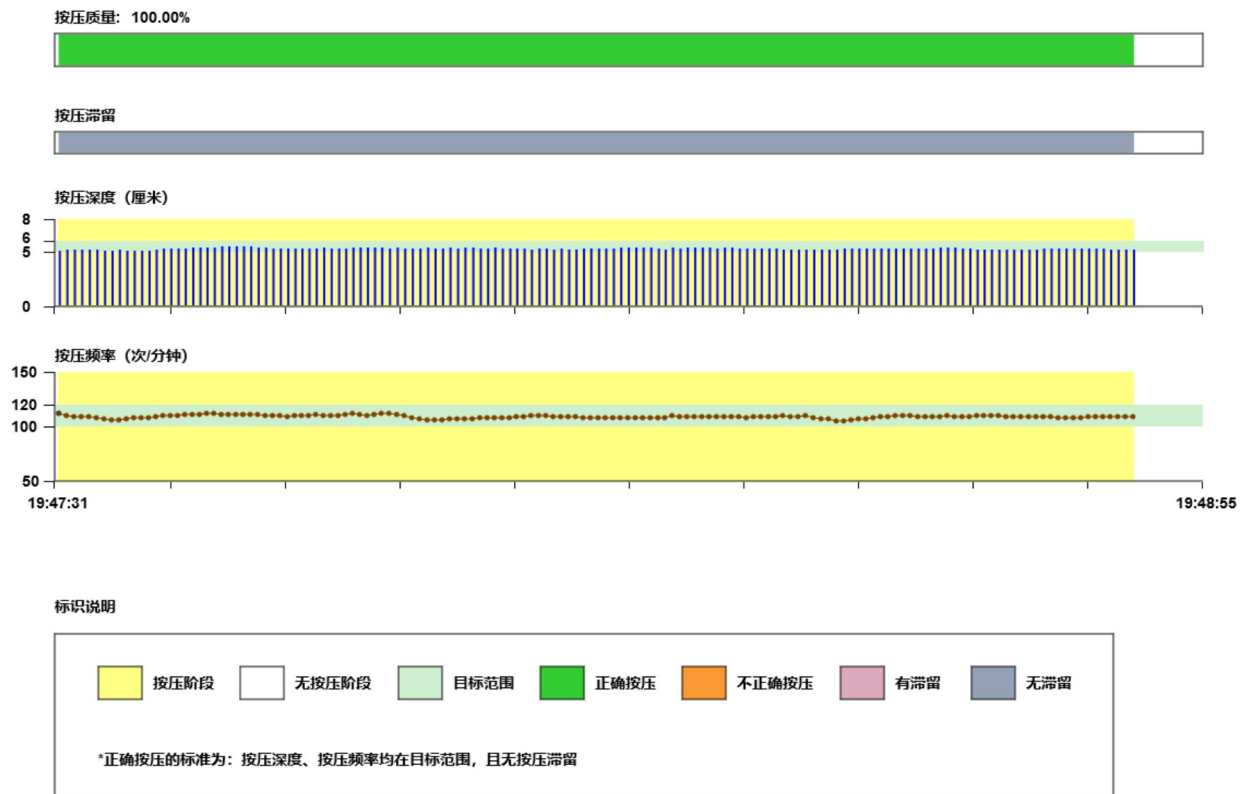

## 按压数据统计

按压质量	数据统计
总时间: 00:01:24	按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]
CCF: 94%	按压深度达标(5-6厘米): 146次 [100.00%]
平均深度: 5.2厘米	按压太浅(小于5厘米): 0次 [0.00%]
平均频率: 108次/分钟	按压太快(超过120次/分钟): 0次 [0.00%]
总次数: 146次	按压频率达标(100-120次/分钟): 146次 [100.00%]
正确次数: 146次	按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]
正确率: 100.00%	按压时间: 00:01:19
按压滞留: 0次 [0.00%]	按压中断时间: 00:00:05

导师签名: