

## 心肺复苏量化培训报告

评估时间： 2018年7月27日 18:45:00

评估导师： 导师1

轮数： 第1轮

## 学员信息

姓名： 22

性别：


编号： 22

单位：

科室：

职务：

## 波形图

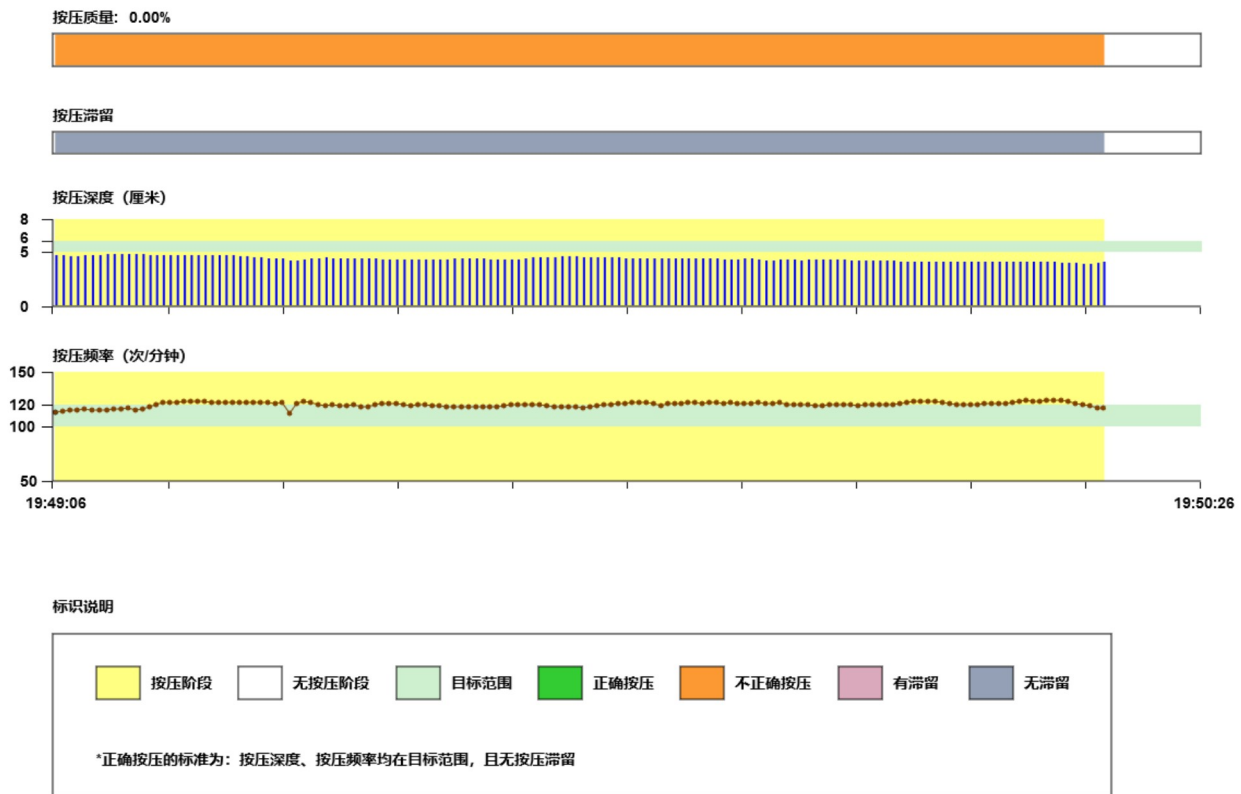

## 按压数据统计

## 按压质量

总时间: 00:01:20  
CCF: 91%  
平均深度: 4.3厘米  
平均频率: 120次/分钟  
总次数: 149次  
正确次数: 0次  
正确率: 0.00%  
按压滞留: 0次 [0.00%]

## 数据统计

按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]  
按压深度达标(5-6厘米): 0次 [0.00%]  
按压太浅(小于5厘米): 149次 [100.00%]  
按压太快(超过120次/分钟): 69次 [46.31%]  
按压频率达标(100-120次/分钟): 80次 [53.69%]  
按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]  
按压时间: 00:01:13  
按压中断时间: 00:00:07

导师签名：