

## 心肺复苏量化培训报告

评估时间： 2018年7月27日 18:45:00

评估导师： 导师1

轮数： 第1轮

## 学员信息

姓名： 24

性别：


编号： 24

单位：

科室：

职务：

## 波形图

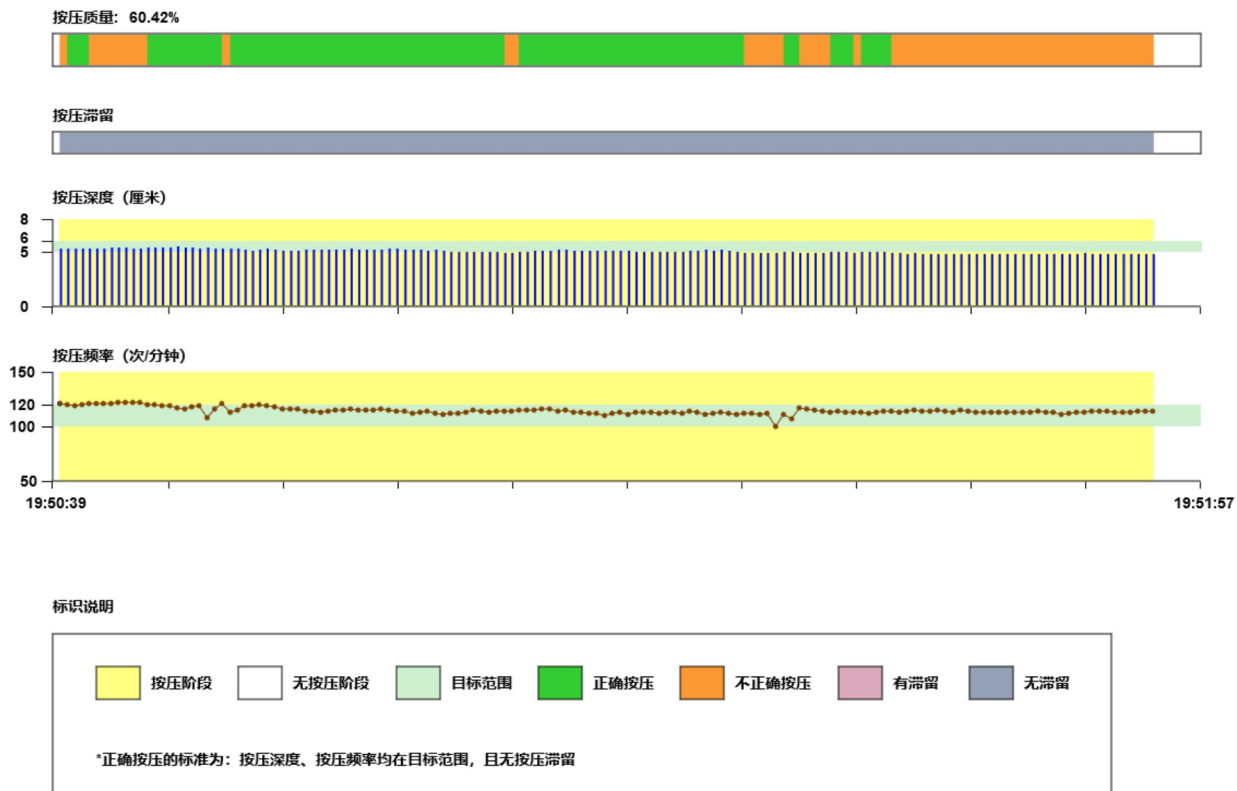

## 按压数据统计

## 按压质量

总时间: 00:01:18  
CCF: 95%  
平均深度: 5.0厘米  
平均频率: 114次/分钟  
总次数: 144次  
正确次数: 87次  
正确率: 60.42%  
按压滞留: 0次 [0.00%]

## 数据统计

按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]  
按压深度达标(5-6厘米): 97次 [67.36%]  
按压太浅(小于5厘米): 47次 [32.64%]  
按压太快(超过120次/分钟): 10次 [6.94%]  
按压频率达标(100-120次/分钟): 134次 [93.06%]  
按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]  
按压时间: 00:01:14  
按压中断时间: 00:00:04

导师签名：