

## 心肺复苏量化培训报告

评估时间: 2018年7月27日 18:45:00

评估导师: 导师1

轮数: 第1轮

## 学员信息

姓名: 42

性别:


编号: 42

单位:

科室:

职务:

## 波形图

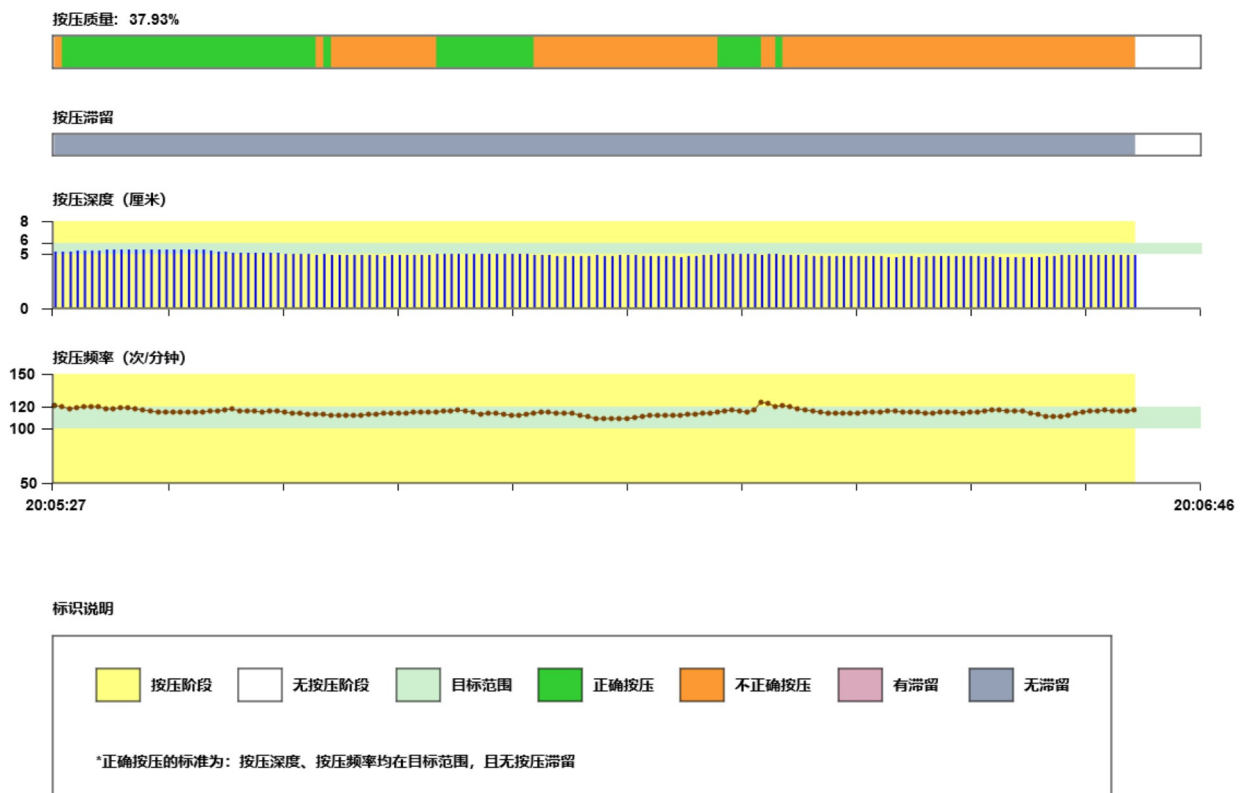

## 按压数据统计

## 按压质量

总时间: 00:01:19  
CCF: 94%  
平均深度: 4.9厘米  
平均频率: 114次/分钟  
总次数: 145次  
正确次数: 55次  
正确率: 37.93%  
按压滞留: 0次 [0.00%]

## 数据统计

按压太深(大于6厘米): 0次 [0.00%]  
按压深度达标(5-6厘米): 57次 [39.31%]  
按压太浅(小于5厘米): 88次 [60.69%]  
按压太快(超过120次/分钟): 4次 [2.76%]  
按压频率达标(100-120次/分钟): 141次 [97.24%]  
按压太慢(低于100次/分钟): 0次 [0.00%]  
按压时间: 00:01:14  
按压中断时间: 00:00:05

导师签名: